2021年10月改訂(第5版)※※

2021年10月改訂(第4版)※

届出番号：27B2X00041000059号

器 68　印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器　歯科用咬合器　JMDN10201000

レイフォスター咬合器(クローム)

【形状・構造及び原理等】

1. 形　状※･※※

形　態　図

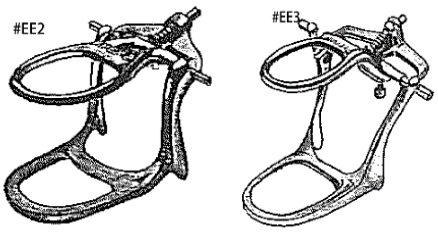

2. 原　理

本器は、上顎部のマウントアームが上下左右に動くことと、前後へのスライド調整ができることで、上下顎歯列の相互位置的関係を技工室で再現できる。

3. 仕　様※･※※

種　類　：　＃ＥＥ2　クラウンブリッジ用

＃ＥＥ3　(フル・パーシャル)デンチャー用

材　質　：　亜鉛ダイキャスト　クロムメッキ

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

補綴物の製作及び、咬合の調整や診断に用いる。

2. 効果

1)患者の上下顎の位置関係並びに、各種の下顎運動要素を、技工室で再現することができる。

2)器種の使い分けにより、単冠からクラウンブリッジ、そしてフルデンチャーに至る補綴物の製作や、修復作業の能率を一段と高めることができる。

【使用方法】

使用方法

1)作業に適応した咬合器を選択し､石膏をマウントする部分に分離材を塗布する。

2)患者の上・下顎の模型を正常咬合させる。

3)通法に従って、咬合器に上・下顎の模型を固定する。

4)模型の固定が安定してから、咬合器の微調整をし、補綴物の製作や修復作業を行う。

【使用上の注意】

1)分解及び改造はしないこと。

2)損傷、変形等のあるものは使用しないこと。

3)本器は、落下の危険や傾斜のない安定した場所で使用すること。

4)本器使用後の洗浄時に、金属タワシやクレンザー(磨き粉)等を使用すると、本器の表面を損傷するので使用を避けること。

5)水洗後は、水分付着による発錆を避けるため、速やかに清拭・乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

1)本器の保管は､即再使用できる様､清潔な状態にして保管すること。

2)本器は高温、多湿及び、水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。

3)本器は室温で、外圧(物理的負荷)及び、落下の危険や傾斜のない安定した場所に保管すること。

4)化学薬品の保管場所や､ガスの発生する場所を避けて保管すること。

【保守点検に係る事項】

保守・点検

損傷・変形等の有無や、本器稼動部（上顎マウントアームの支点、ネジ、スプリング）の石膏付着等の状況を点検し、潤滑油等の注入を行い、常に清潔を保つこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　：　サンデンタル株式会社

製 造 業 者　：　RAY FOSTER DENTAL EQUIPMENT

国　　名　：　アメリカ

取扱説明書等を必ずご参照下さい。